


	RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - RPE			Código: RPE - 074
	Data Emissão: 03.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 1 de 2	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA AHLVF				
ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL nº 08/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

OBJETIVO:

Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento de fornecedor sobre os termos e/ou descrições contidas no edital supracitado. Sua circulação é pública e disponível na plataforma web da instituição.

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

O representante/preposto dos equipamentos KONICA MINOLTA manifestou seu desejo de participar do processo licitatório e encaminha Pedido de Esclarecimento com o seguinte teor (extrato do encaminhamento de pedido):

“Item 02 – CR Digitalizador de Imagens;



(...) Resolução de escala de cinza e aquisição de dados de 16 A 20 Bits/pixel (...)

Alteração: Solicitamos a alteração da exigência para “12 a 20 bits/pixel”, pois somente 1 empresa (Fabricante Agfa) consegue atender ao solicitado, cerceando a participação de mais fornecedores. A alteração não irá descaracterizar o equipamento exigido.

3 – RESPOSTA AO PEDIDO:

Agradecemos o interesse do fornecedor, e passamos a responder suas dúvidas/pedidos:


- a) Os descritivos do banco de dados do sistema de gestão de ativos do HRO são referenciais e procuram propiciar a ampla participação e concorrência dos interessados.
- b) Quando estamos falando de PROFUNDIDADE DE BITS (12 a 20 ou 16 a 20 bits/pixel) estamos falando de quantas gradações únicas de cinza são capazes de serem observados. Em imagens radiográficas, isto é de extrema relevância, já que a diferença não é de apenas 4 bits como pode parecer, e sim de milhares de gradações de tons que podem ser observadas. Esta diferença se traduz em qualidade no diagnóstico.

	RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - RPE			Código: RPE - 074
	Data Emissão: 03.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 2 de 2	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA AHLVF				
ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL nº 08/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

- c) Aconselhamos o fornecedor a entrar com o seu melhor produto para o atual descritivo, pois a instituição utiliza uma avaliação multicritérios, e outras características técnicas podem vir a suplantam esta diferença na qualidade de imagem.

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que nos couber,

Chapecó, 03 de outubro de 2016.

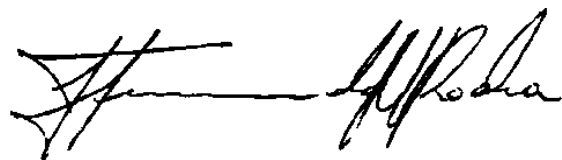

Eng. J Fernando Meira da Rocha
 CREA: 054.300 D